


Kamera- karbantartás felmérése

28 labor adatai

77 gamma-kamera + 2 PET/CT


Varga J., 2013. dec.

Karbantartás laboronként

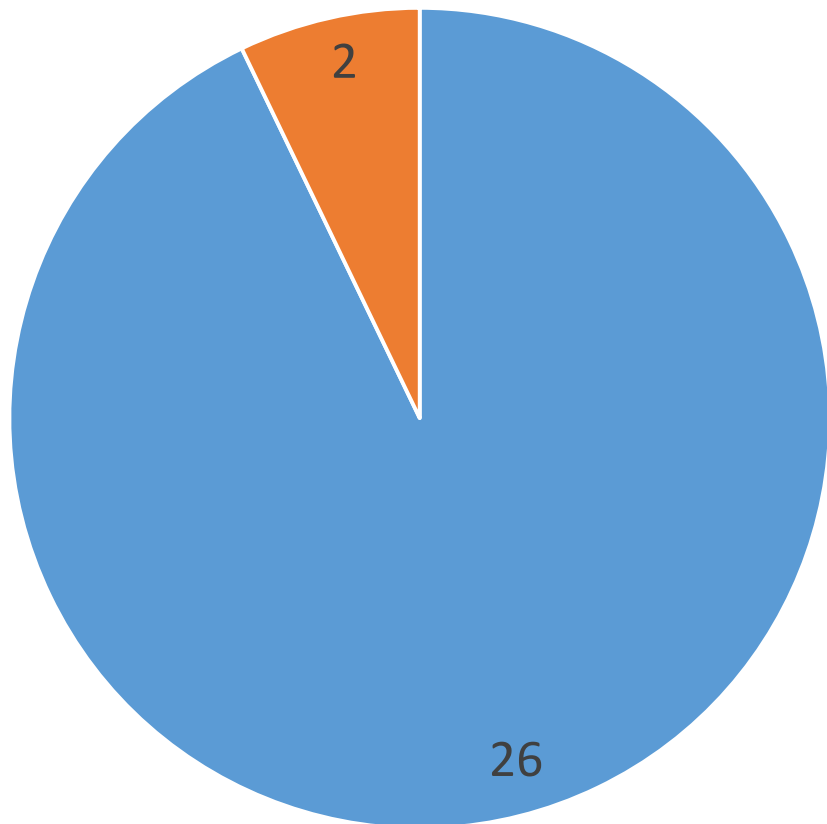


■ Van ■ Nincs

Karbantartás kameránként

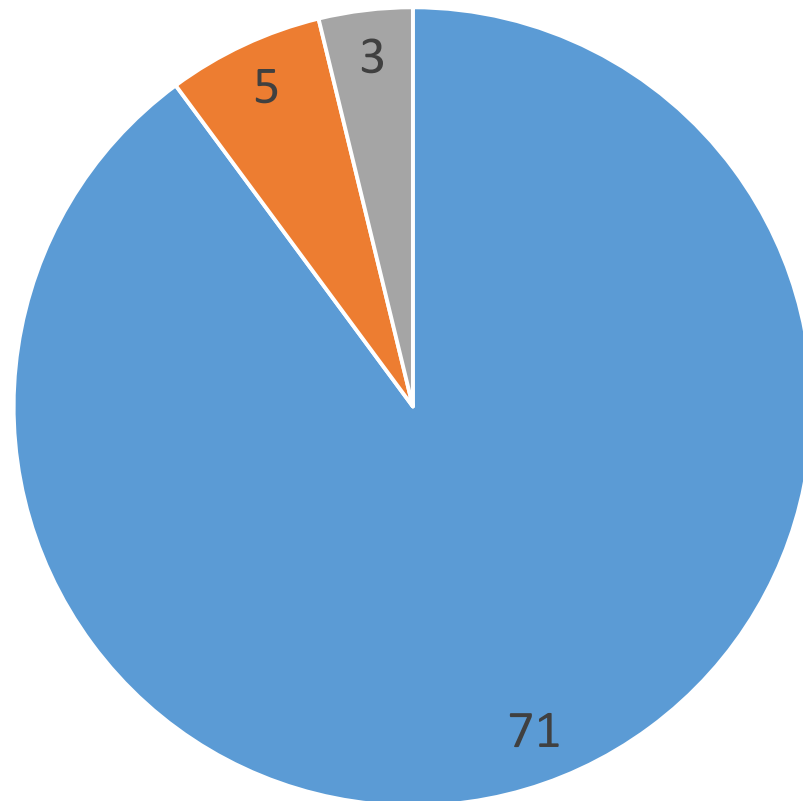


■ Van ■ Nincs ■ Alkalomszerűen


Hány gamma-kamera van egy laborban?

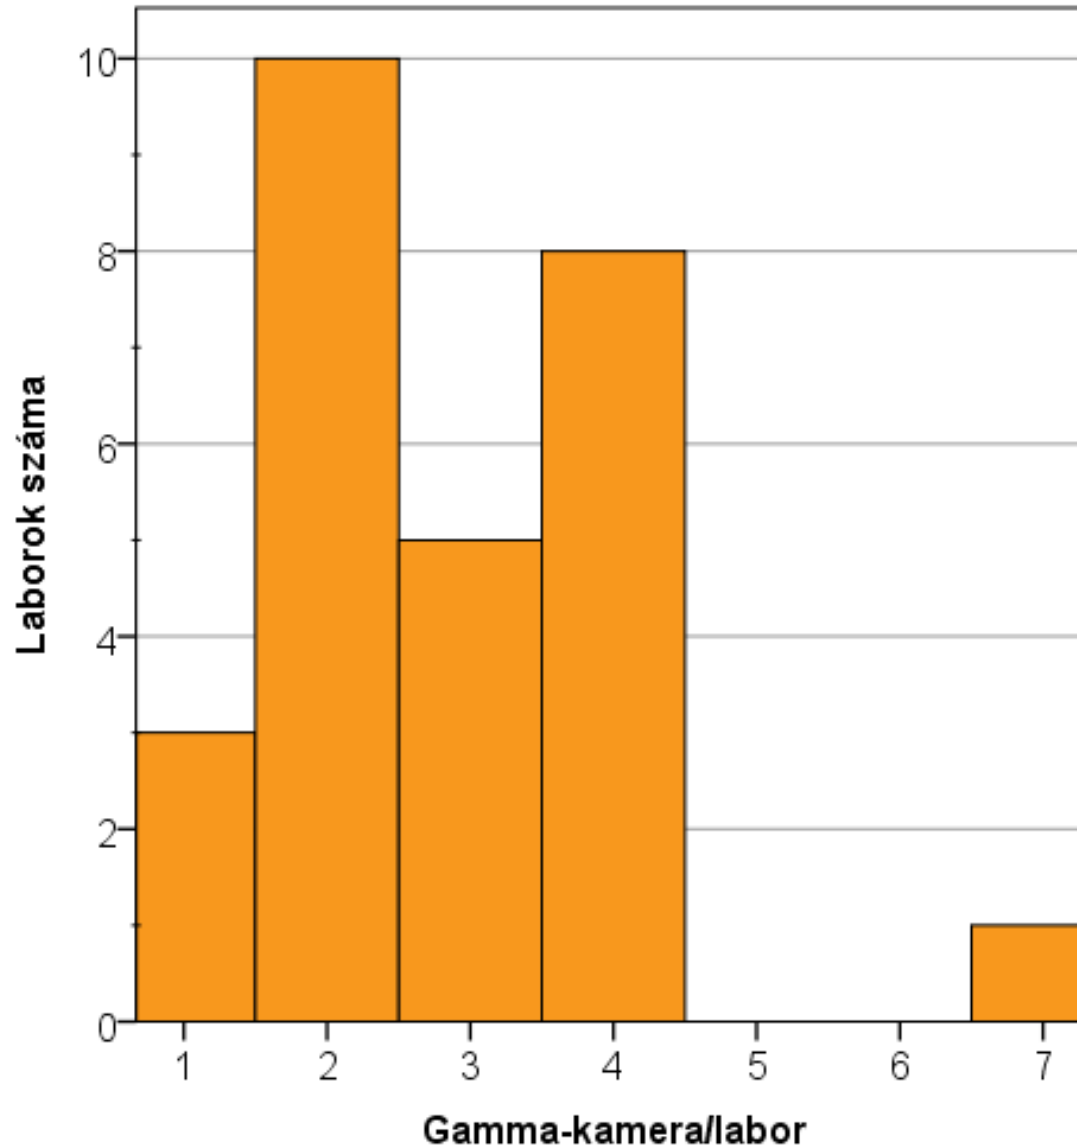

Kor a legutóbbi felújítás óta

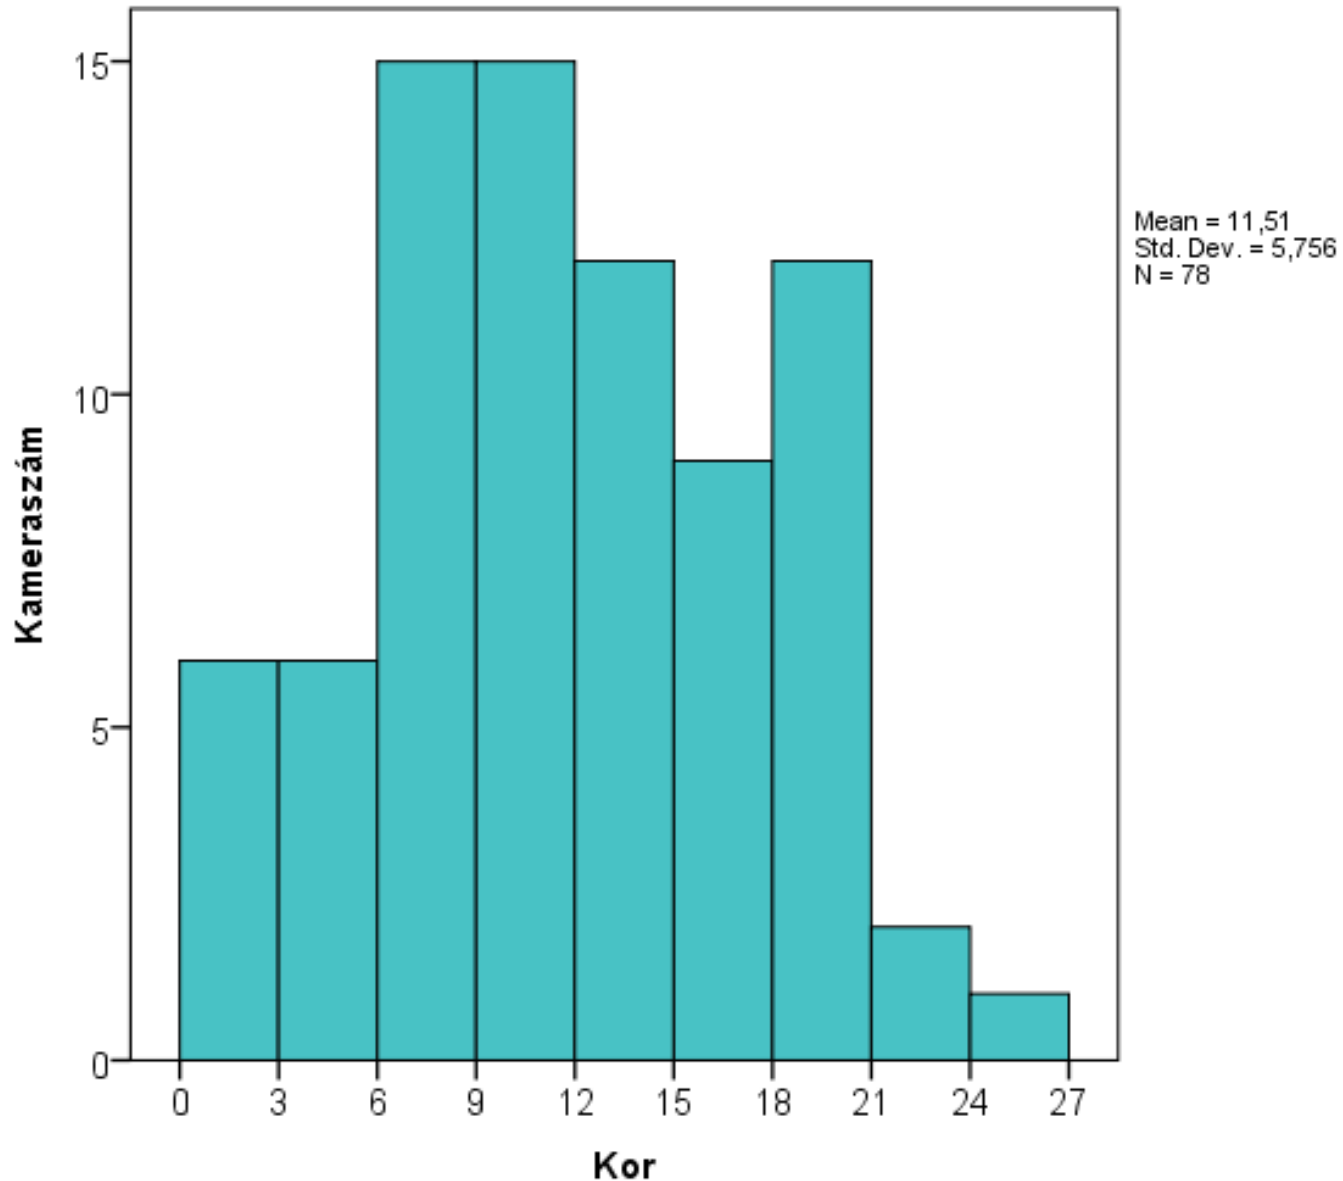

Kor szerinti megoszlás

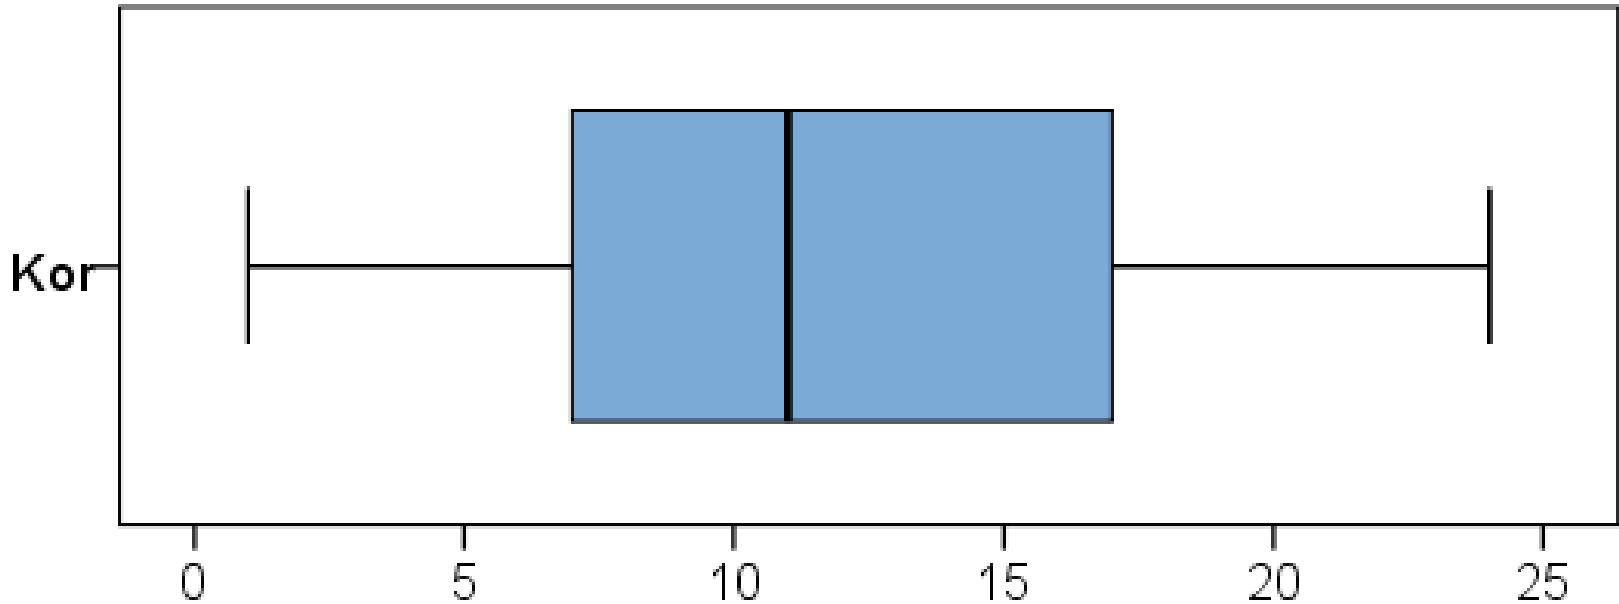

| | | |
|-----|-------------------|----------|
| Kor | Átlag | 11,51 év |
| | Std. Deviation | 5,756 |
| | Minimum | 1 |
| | Maximum | 24 |
| | Tartomány | 23 |
| | Negyedelő pontok: | 7; 17 |

Éves karbantartási szám kameránként

