


# Kamera-karbantartás felmérése

28 labor adatai

77 gamma-kamera + 2 PET/CT


Varga J., 2013. dec.

Karbantartás laboronként

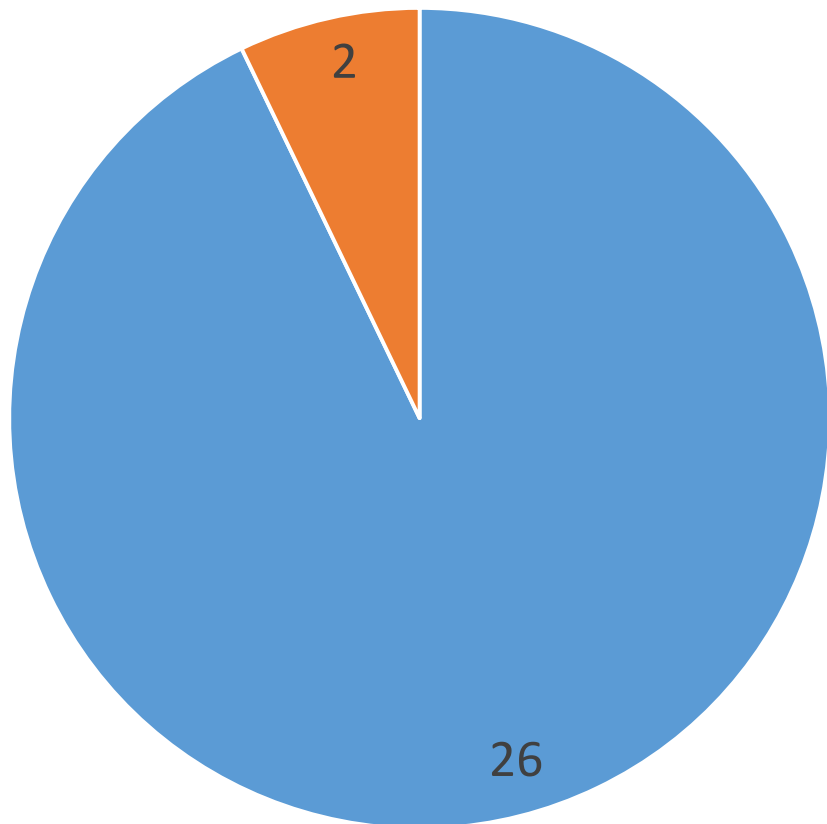


■ Van ■ Nincs

Karbantartás kameránként

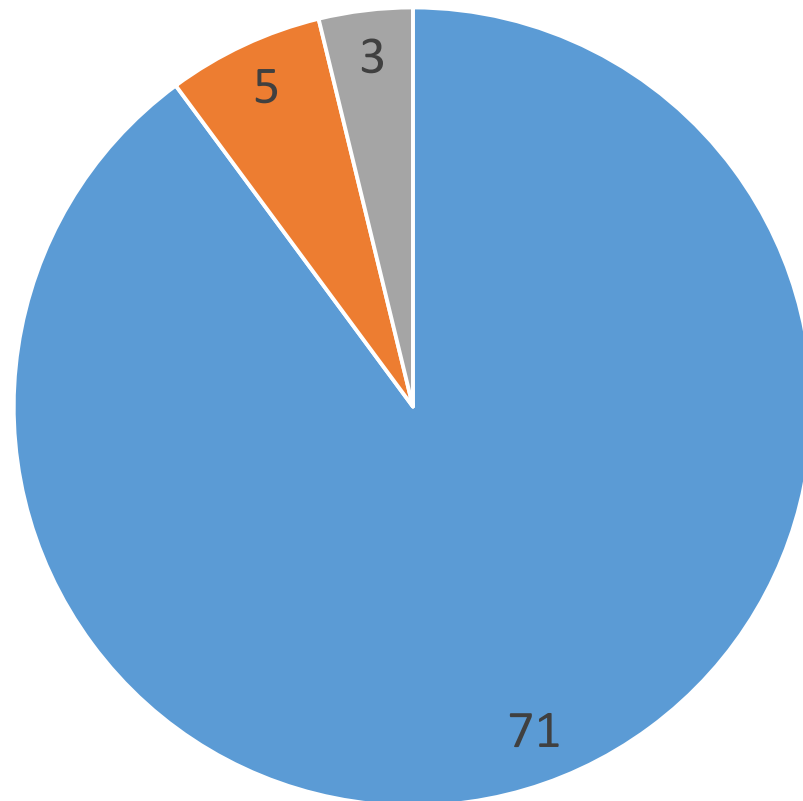


■ Van ■ Nincs ■ Alkalomszerűen


# Hány gamma-kamera van egy laborban?

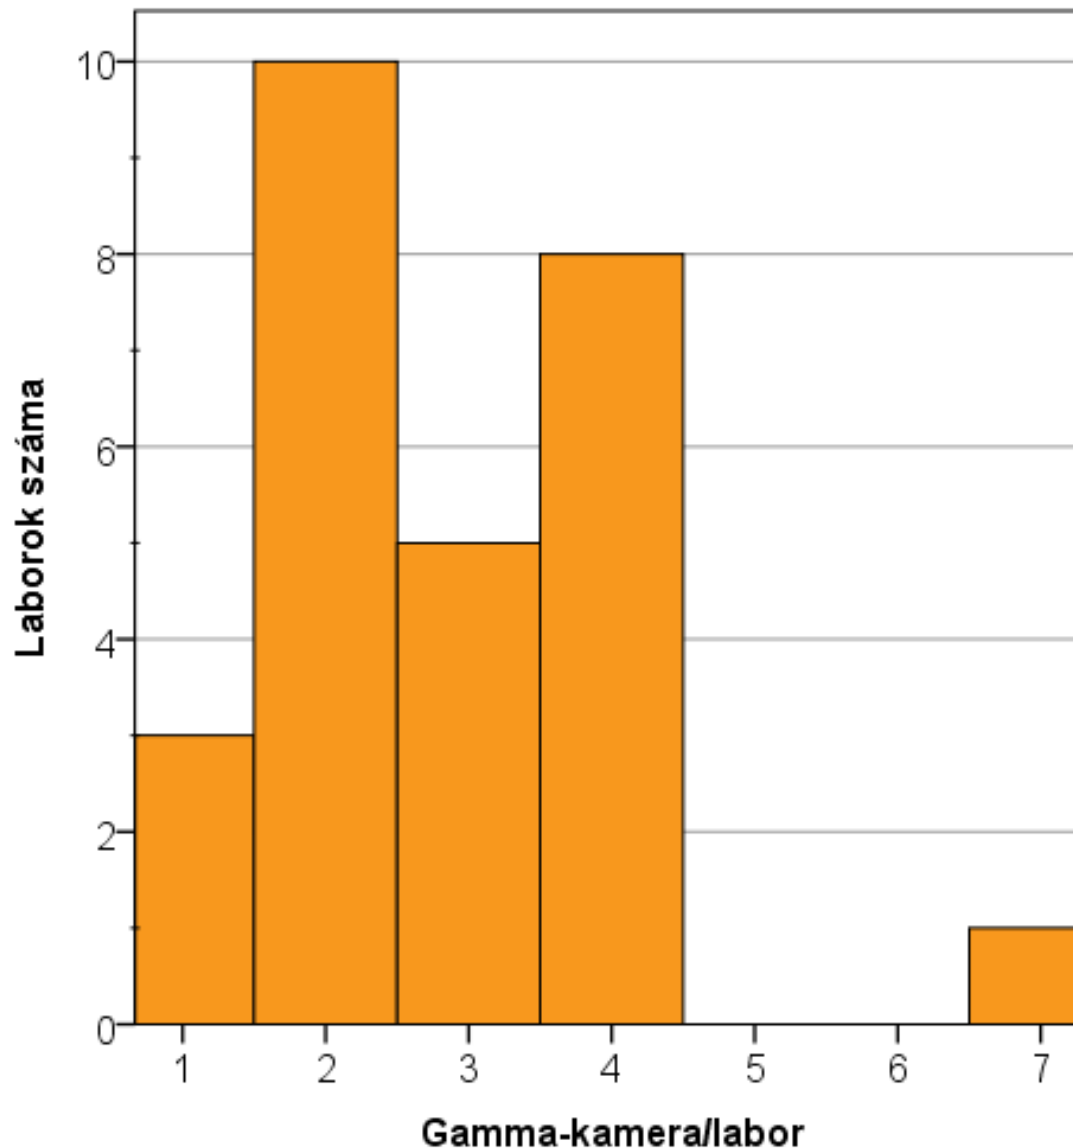

# Kor a legutóbbi felújítás óta

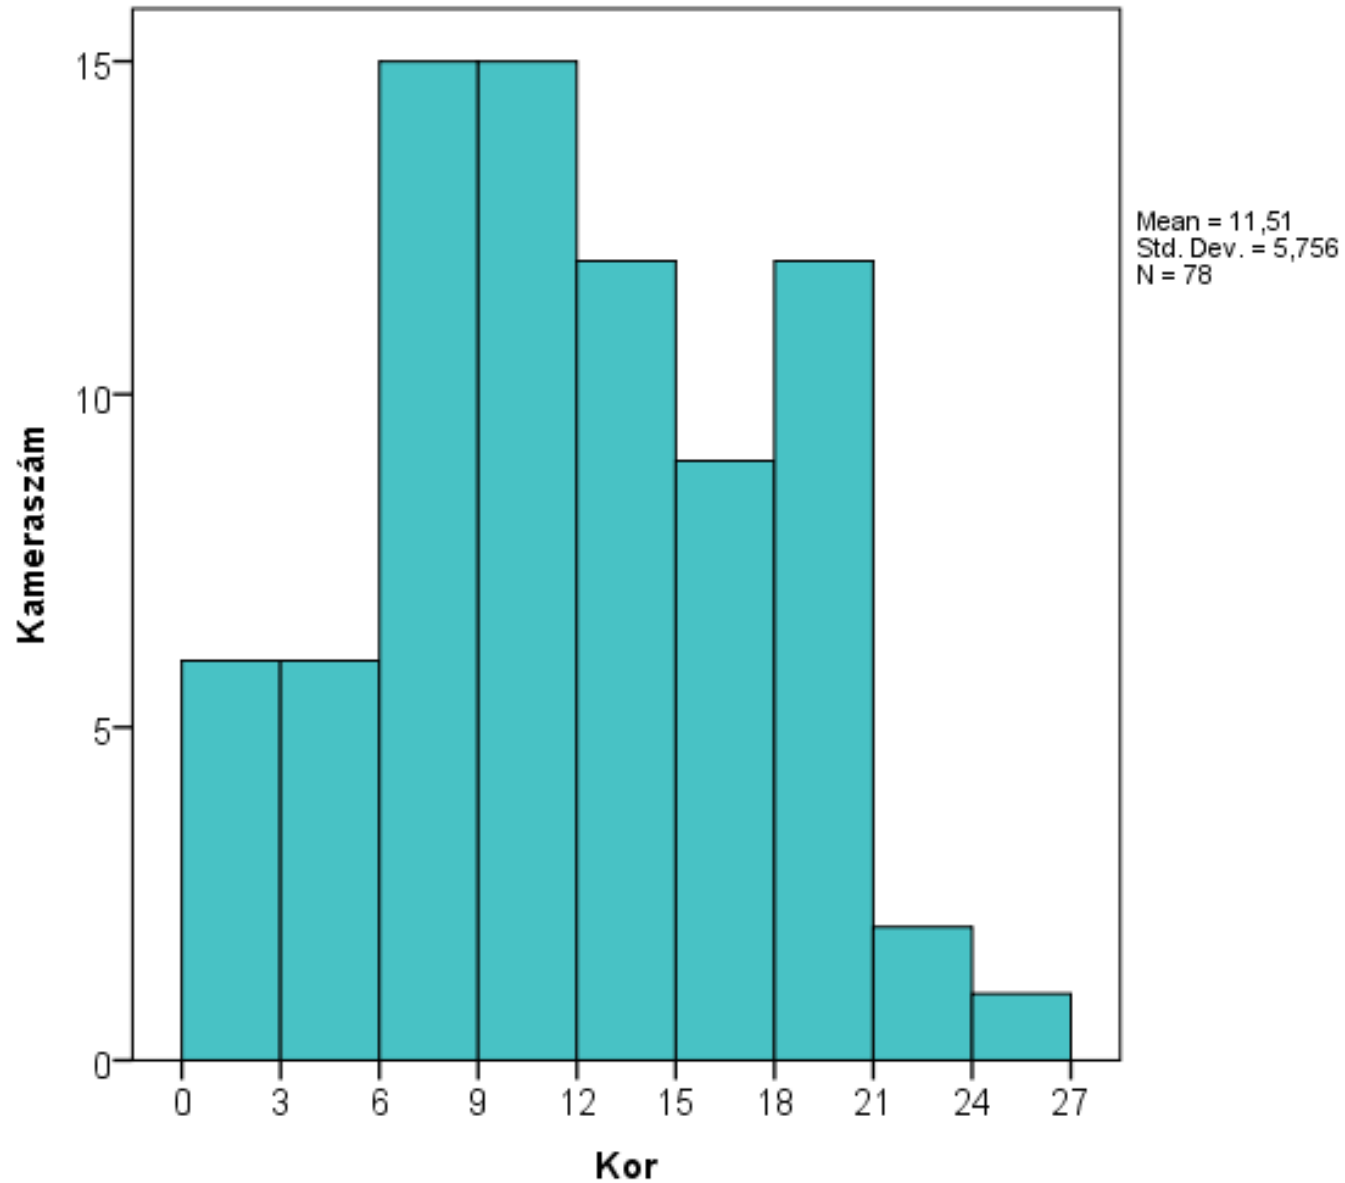

# Kor szerinti megoszlás

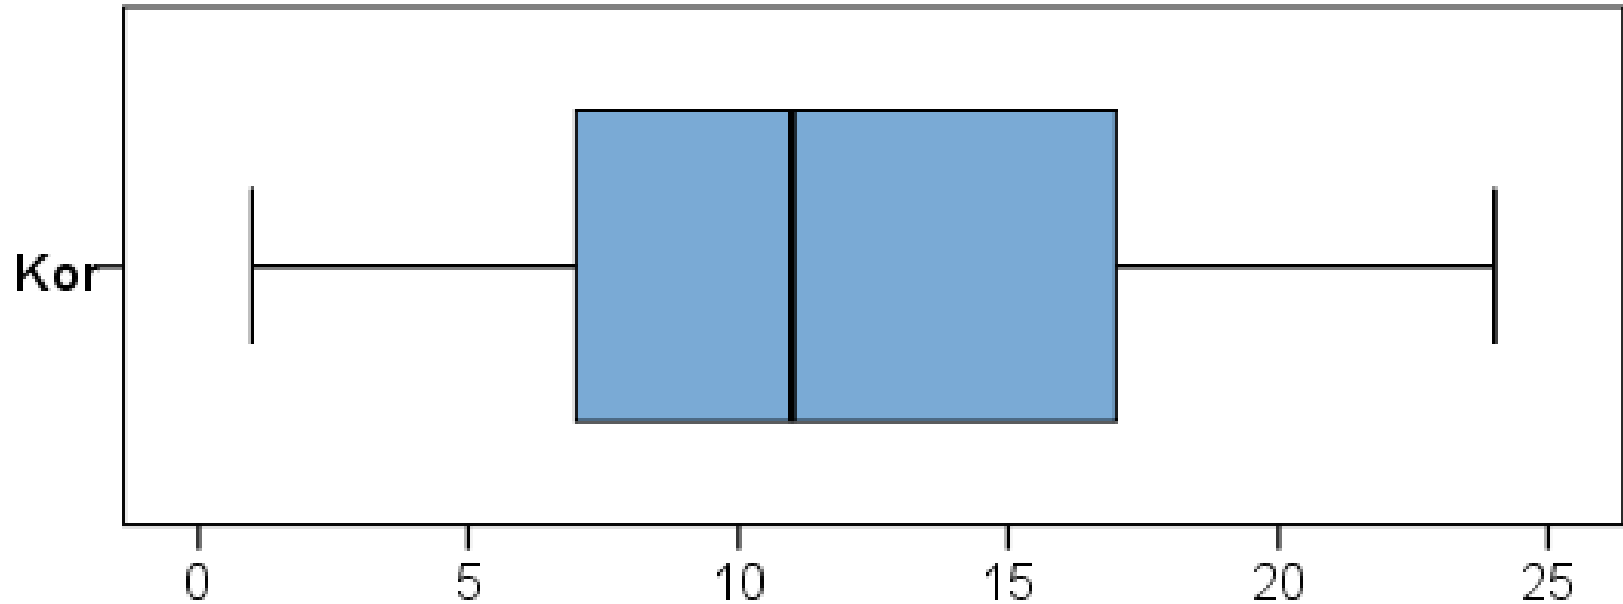

Kor	Átlag	11,51 év
	Std. Deviation	5,756
	Minimum	1
	Maximum	24
	Tartomány	23
	Negyedelő pontok:	7; 17

# Éves karbantartási szám kameránként

